

## MANUALE DI ISTRUZIONI BILANCIA PCE-BS 6000



- **SICUREZZA**
- **DESCRIZIONE BILANCIA**
- **REALIZZAZIONE DELLA PESATURA**
- **CALIBRATURA**
- **SPECIFICHE TECNICHE**

## SICUREZZA

Tutti i punti rilevanti per motivo di sicurezza sono rilevati con i messaggi "**WARNING**" e "**CAUTION**", che significano quanto segue:

△ <b>WARNING</b>	Se non rispetta questa indicazione si possono produrre gravi danni allo strumento ed anche al personale, per cui è necessario rispettare obbligatoriamente questa indicazione.
△ <b>CAUTION</b>	Questo messaggio le fornisce informazione per evitare che si producano danni.

Se utilizza una di queste bilance, dovrà rispettare queste indicazioni:

### △ **WARNING**

Utilizzi unicamente l'adattatore di corrente AC della spedizione. Qualsiasi altro adattatore può danneggiare il componente interno.

### △ **CAUTION**

Non esponga la bilancia a radiazione solare diretta, dal momento che si possono produrre errori nell'uso delle sue funzioni.

Utilizzi sempre batterie dello stesso modello. Ogni volta che effettua un cambio, cambi tutte le batterie insieme.

Tolga le batterie dal comparto se non utilizza la bilancia per un periodo di tempo prolungato, così potrà evitare danni alla bilancia provocati dallo scaricamento delle batterie.

Eviti tensioni troppo alte (scelta scorretta della batteria).


Eviti che penetrino gocce d'acqua all'interno della bilancia. La corrosione interna provoca danni.

Una carica statica ha influenza sul modo di misurazione digitale. A questo scopo dovrà scaricare previamente i componenti che vuole pesare o utilizzi uno spray antistatico (per esempio sul piatto di pesata). Non collochi la bilancia vicino a campi elettrici di carica alta.

## DESCRIZIONE BILANCIA

### Parte Sinistra

Presse per alimentatore AC




### Parte Superiore

Bilancia idrostatica

Piatto di pesata

Supporto rotondo per il piatto che deve posizionarsi bene

Indicatore

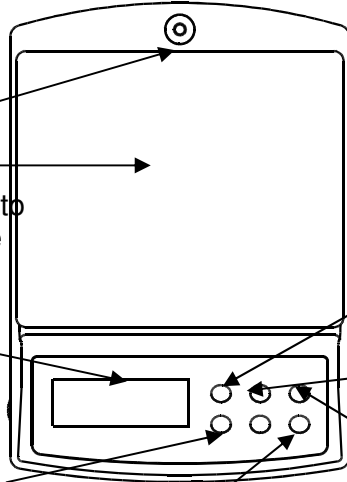

Tasto HOLD

Tasto CAL


**ON/OFF** (acceso / spento)  
Con questo tasto si accende e si spegne la bilancia

Tasto **UNIT** Cambia indicatore di unità

Tasto **ZERO - TARA**  
Mettere l'indicatore a '0'.  
Resta il peso del recipiente.


### Parte Posteriore

Coperchio della batteria

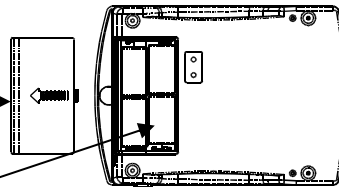

Compartimento della batteria

Batterie (6 da 1,5V)



### Display / Indicatore

HOLD

**ZERO** (Indicatore nullo)

Campo dell'indicatore:  $\pm 4\%$



Indicatore unità di misura

Indicatore della batteria

**TARA** Il range della tara è parte del range di misura massimo  $+9e$

## REALIZZAZIONE DELLA PESATA

### 1. Collocare le batterie / Collegare alla rete

#### BATTERIE

Tolga il coperchio del comparto delle batterie

Collochi le 6 batterie nuove AA (non incluse nella spedizione) – tenga presente la polarità

#### ALIMENTATORE AC

Introduca l'alimentatore AC nella presea corrispondente.

Introduca l'alimentatore nella presa da 230V.

### 2. Disposizione della bilancia nel luogo di pesatura

Non la metta sotto la luce solare diretta e se è possibile lontano da vibrazioni.

Tenga presente la sconnessione automatica.

La bilancia si spegne automaticamente: dopo 3 minuti di inattività o se sostiene un peso senza movimento (per proteggere la batteria).

#### Messaggio di errore

EEEE: Sovraccarica (la cellula di pesatura è sovraccarica e forse danneggiata)

- Prema il tasto [ON/OFF].  
L'indicatore mostra tutti i segmenti (88888) per alcuni secondi e di seguito mostra il messaggio "0".
- Selezione dell'unità di pesatura [UNIT].  
Prema il tasto [UNIT] per selezionare l'unità "kg", "g", "lb", "oz".
- Realizzazione di una pesatura  
Metta l'oggetto da pesare sul piatto di pesata. Legga il risultato una volta che l'indicatore sia stabile.

#### Funzione HOLD

Premendo il tasto "Hold" il valore si mantiene "congelato" nel display per 12 secondi.

Collochi l'oggetto da pesare sul piatto.

Prema il tasto Hold e nel display compare il simbolo "Hold".

Tolga l'oggetto dalla bilancia. Il suo peso rimane sul display.

Prema il tasto Zero per cancellare l'ultimo valore che si è trattenuto sul display. Se vuole uscire dal modo "HOLD" prema il tasto Hold per un certo periodo di tempo. Adesso si trova nuovamente nel modo normale.

#### TARA/Azzeramento

Si può effettuare una tara premendo il tasto [ON/OFF]. (la tara si può effettuare più volte fino alla metà del range di misura al massimo).

#### Computo dei pezzi


Prema il tasto [ON/OFF]. Selezioni l'unità [g] con il tasto [UNIT]. Collochi di seguito un numero determinato di oggetti (p.e. 10 pezzi) sulla bilancia. Con il tasto [UNIT] cambi l'unità [pcs]. Prema il tasto [PCS] nel display della bilancia. Compare il computo minimo dei pezzi da selezionare (p.e. per 10 pezzi: 5 = 10 etc. Premendo varie volte il tasto [PCS] potrà selezionare differenti computi minimi di pezzi. Una volta realizzata la selezione, effettui la conferma premendo una volta il tasto [UNIT]. Nel display compare brevemente il messaggio „PASS“. Adesso può collocare un numero indeterminato di oggetti sulla piattaforma e leggere il numero di pezzi direttamente nel display. Può anche ritornare all'unità [g] con il tasto [UNIT] e leggere il peso di questa quantità di pezzi ancora sconosciuta.

## CALIBRATURA

### Quando si deve effettuare una calibratura?

La prima volta che la mette in funzione, la bilancia mantiene la calibratura di fabbrica, ma può essere ricalibrata per esempio quando la cambia di luogo. Per il resto, dovrà rispettare gli intervalli di calibratura abituali (annuale secondo le normative DKD o ISO) o se la bilancia si trova in un luogo con forti influenze di agenti esterni (polvere, sporcizia, alta umidità relativa).

### Modo di calibratura

1. Prima di attivare il modo di calibratura preme il tasto per accendere la bilancia.
2. Prema di seguito il tasto **[CAL]** per 2 secondi, nel display comparirà "CAL", e di seguito compare un "0" lampeggiante.
3. Prema di nuovo il tasto **[CAL]**, nel display compare "0" e di seguito comincia a lampeggiare mostrando il messaggio "full load weight value" (valore di pesatura massimo), trascorso 1 secondo.
4. Collochi un peso (p.e. 4 kg) sul piatto di pesata.  
Prema il tasto **[CAL]**, e nel display compare "PASS", e ritornerà al modo di pesatura normale. Compare il messaggio "2000", così si conclude la calibratura.
5. Spenga la bilancia con il tasto  e la riaccenda. Faccia alcune misurazioni. Se si verificano oscillazioni, ripeta il procedimento di calibratura. Ci può anche inviare la bilancia per effettuare una calibratura ISO nel laboratorio a cui ci appoggiamo.

## SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	<b>PCE-BS 6000</b>
RANGE DI MISURA	<b>0 ... 3000 g</b>
RISOLUZIONE	<b>0,1 g</b>
PIATTO DI PESATA	<b>140 x 165 mm</b>
PESO	<b>900 g</b>
TEMPERATURA OPERATIVA	<b>0 ... + 40°C</b>
ALIMENTAZIONE	<b>6 batterie da 1.5 V</b>
	<b>Alimentatore da 9V / 100 mA</b>

Rispetti le direttive sui residui e depositi la bilancia in un luogo adeguato:

